

LSMの測定部と表示部の互換性について

【例えば・・・】


古いレーザー測定部は現行モデルの表示部に接続可能か？



「表示部」と「測定部」を接続しご利用いただくLSM(レーザースキャンマイクロメータ)は、旧モデルと現行モデルとの互換性がありません。接続不可です。

また、旧モデルは修理対応も終了しています。

旧モデルから現行モデルへお買い換えの際は表示部・測定部共に更新していただく必要があります。

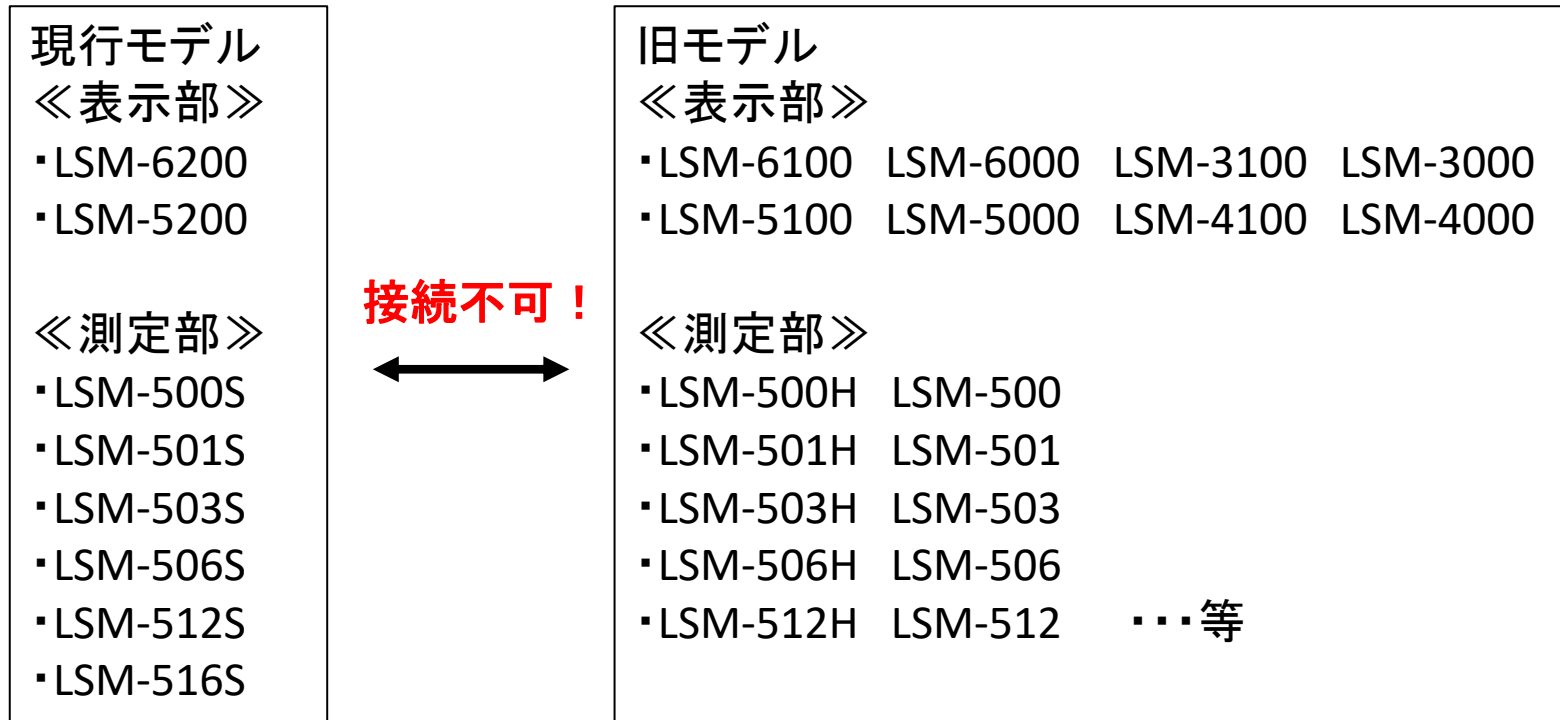

ご不明な点がありましたら……

最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

<https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale>

※装置に組み込まれたLSMを使われている場合はお手数ですが一旦装置メーカー様にご相談ください。